

各位

平成18年5月31日


放射線取扱主任者

伴 秀一

「機構長の指定する放射線の発生を伴う機器」の使用について

本機構予防規程に基づく「機構長の指定する放射線の発生を伴う機器」として、下記装置の使用願いが平成18年5月16日付けで提出されました。同装置について、管理区域の区画及び標識、インターロックシステム、出入管理の方法、黄色パトライト等の放射線安全設備を確認し、5月26日から使用開始を認めましたのでお知らせ致します。

1. 機器名 TAライナック用電子銃テストスタンド
2. 使用場所 電子陽電子入射器棟 旧クライストロン準備室
3. 当該主幹等 榎本 収志
4. 発生装置管理責任者 大澤 哲
5. 放射線担当者 本間 博幸
6. 放射線管理区域責任者 佐波 俊哉
7. 放射線業務担当者 高橋 一智
8. 性能等 最大印加電圧：50kV 最大電流：DC3mA(パルス10A)

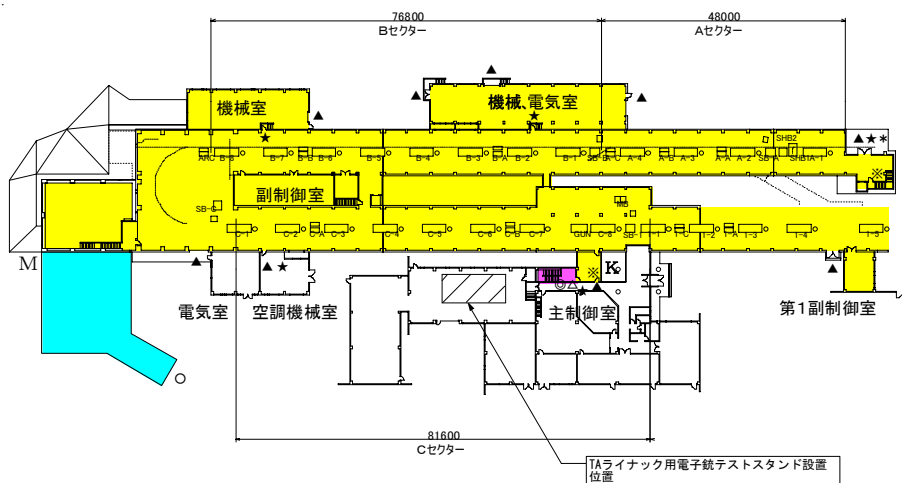

配布先

機構長 (素核研) 所長、副所長 (物構研) 所長、副所長 (加速器) 施設長、総主幹、各主幹 (共通) 施設長、各センター長 当該発生装置管理責任者、同作業責任者
各区域放射線担当者、各研究施設事務室、管理室員、安全係