

各位

平成24年6月15日

放射線取扱主任者

佐々木 慎一


「機構長の指定する放射線の発生を伴う機器」の使用について

本機構予防規程に基づく「機構長の指定する放射線の発生を伴う機器」として、下記装置の使用願いが平成24年6月11日付けで提出されました。同装置について、管理区域の区画及び標識、インターロックシステム、出入管理の方法、黄色パトライト等の放射線安全設備を確認し、平成24年6月15日から使用開始を認めましたのでお知らせ致します。

1. 機器名 RF高電界試験装置
2. 使用場所 電子陽電子入射器棟クライストロンギャラリー1-4セクター
3. 当該主幹等 古川和郎
4. 発生装置管理責任者 肥後寿泰
5. 放射線担当者 本間博幸
6. 放射線管理区域責任者 佐波俊哉
7. 放射線業務担当者 中村一
8. 性能等

レバンドクライストロン (40MW、 $4\mu\text{s}$ 、50Hz；最大カソード電圧350kV、同電流460A) 1台

レバンド加速管 2m × 1台 (定格15MW投入時に12.2MV/m)

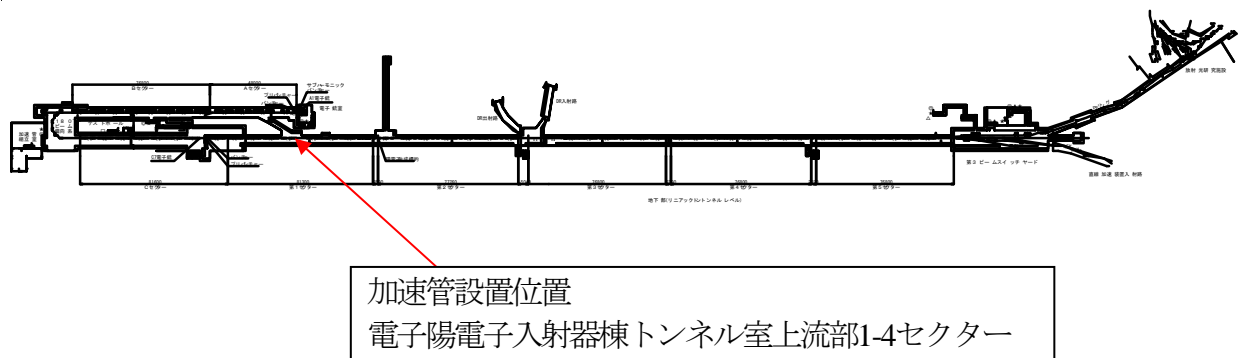

配布先

機構長 (素核研) 所長、副所長 (物構研) 所長、副所長 (加速器) 施設長、総主幹、各主幹 (共通) 施設長、各センター長 当該発生装置管理責任者、同作業責任者
各区域放射線担当者、各研究施設事務室、管理室員、安全衛生推進室