

各位

平成 29 年 10 月 12 日  
放射線取扱主任者

大強度放射光リング（PF-AR）における放射線障害防止法施行規則  
第 22 条の 3 項の適用期間の延長について

大強度放射光リングにおいて、放射線障害防止法施行規則第 22 条の 3 項に基づき、  
2017 年 5 月 18 日～10 月 16 日の期間は下記の管理区域を管理区域でないものと見  
なし、周辺監視区域と同様の出入り管理を行っておりますが、適用期間を下記の通り  
延長することをお知らせします。

1. 期 間：2017 年 5 月 18 日（木） から **2017 年 10 月 30 日（月）** まで
2. 場 所（図 1～図 7 の赤線で囲まれた区域）：
  - a) 北西実験棟・地上階、及び、地下 1 階
  - b) 北実験準備棟・地上階、地下 1 階、及び、地下 2 階
  - c) 放射光実験施設・地上階、及び、地下 1 階

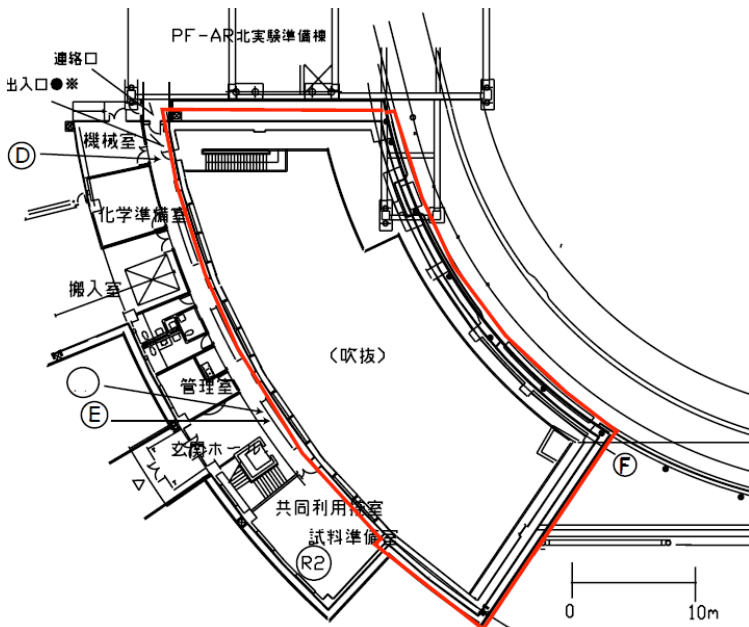


図 1 北西実験棟・地上階

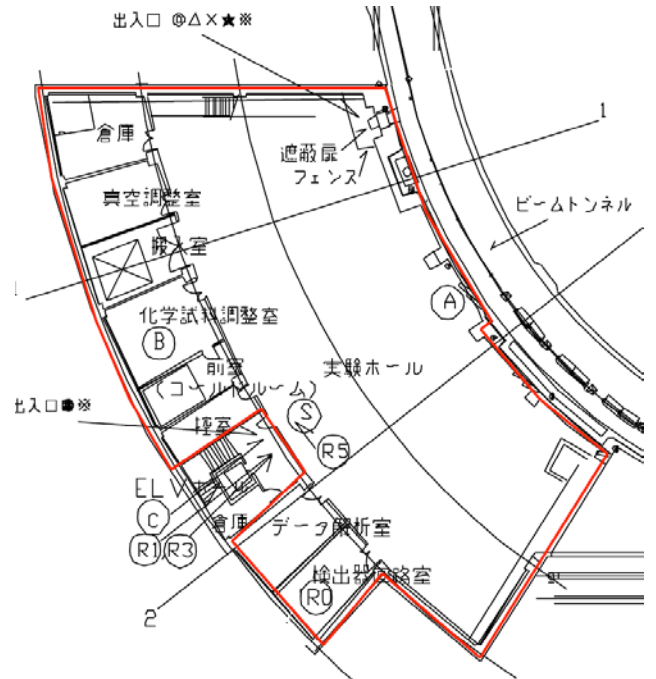


図 2 北西実験棟・地下 1 階

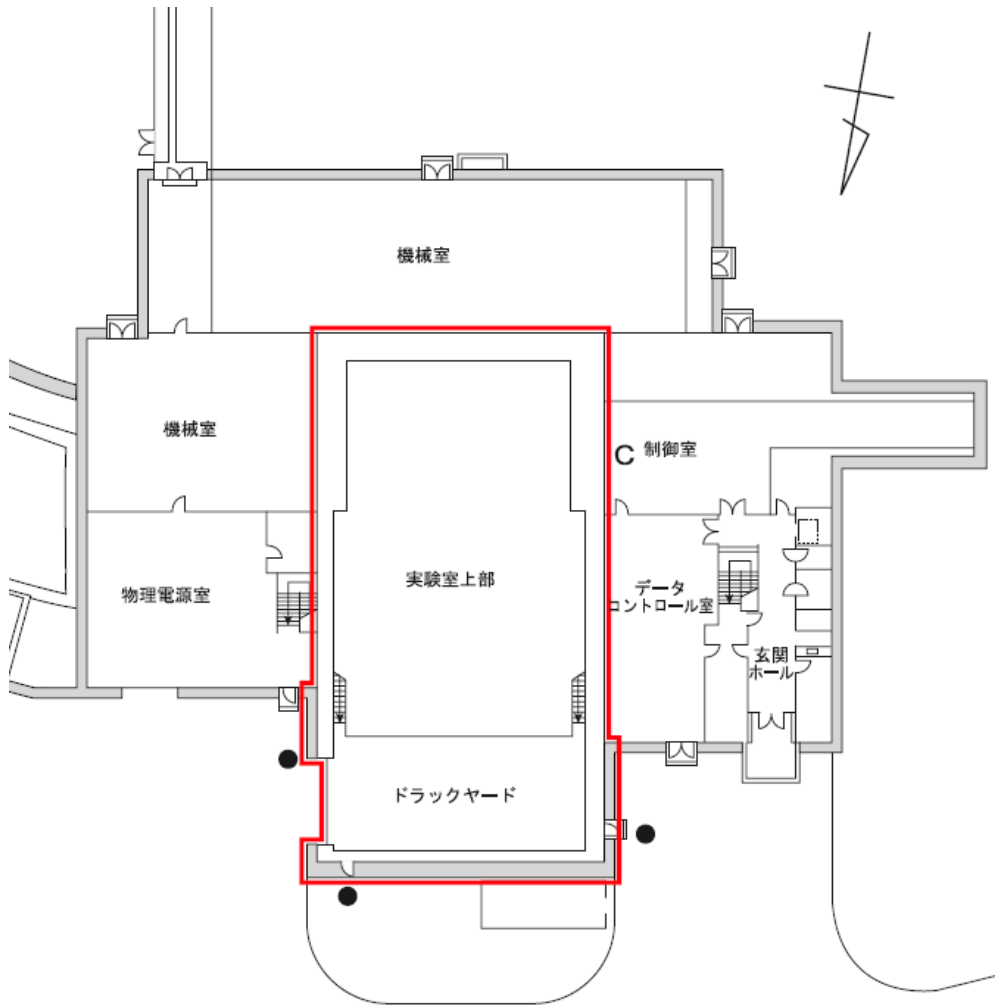


図3 北実験準備棟・地上階

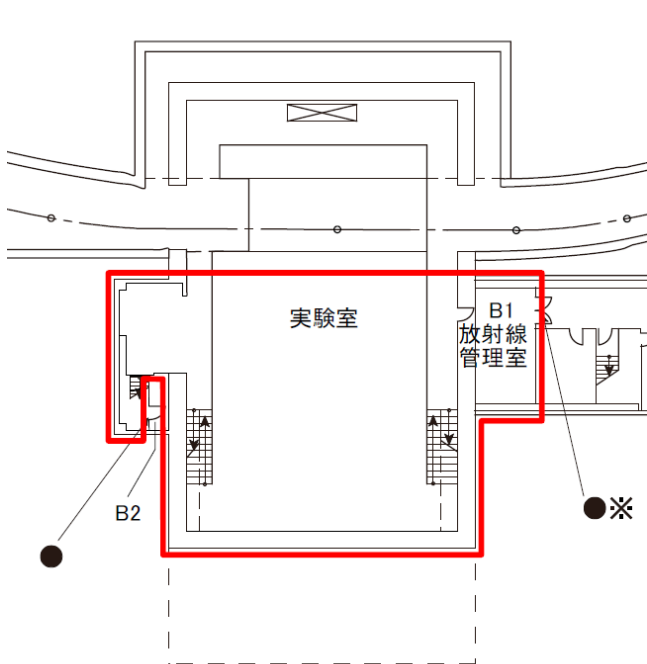


図4 北実験準備棟・地下1階

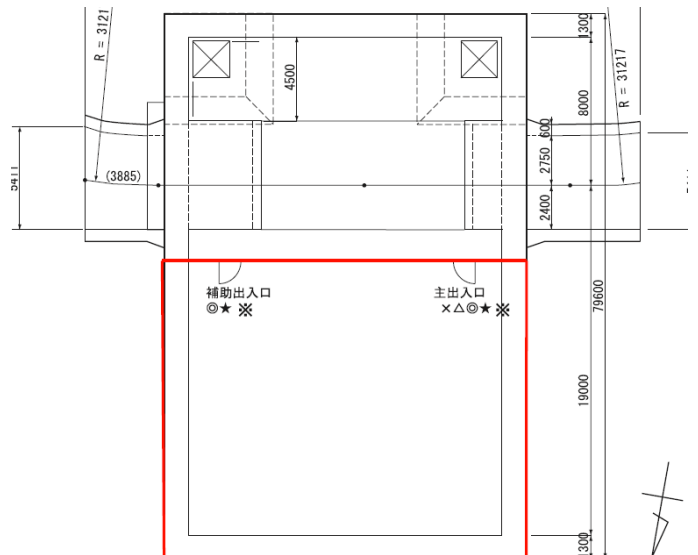


図5 北実験準備棟・地下2階

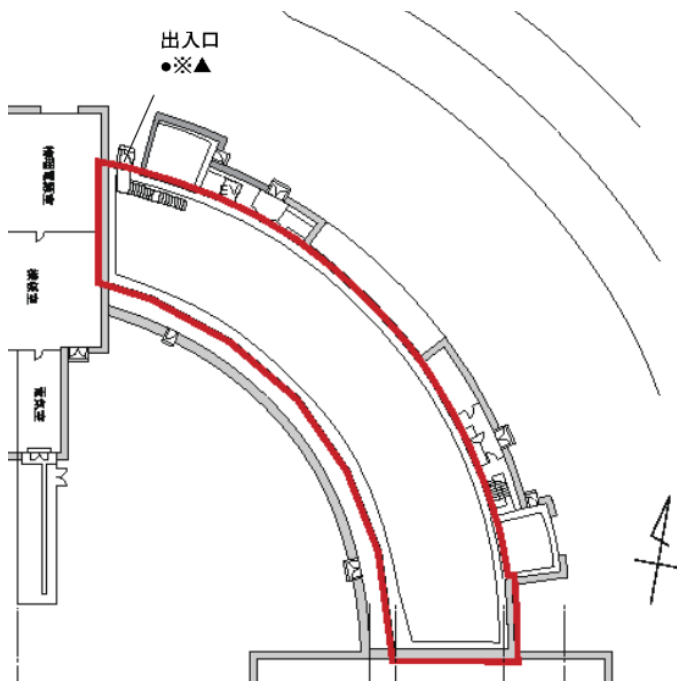


図 6 放射光実験施設・地上階

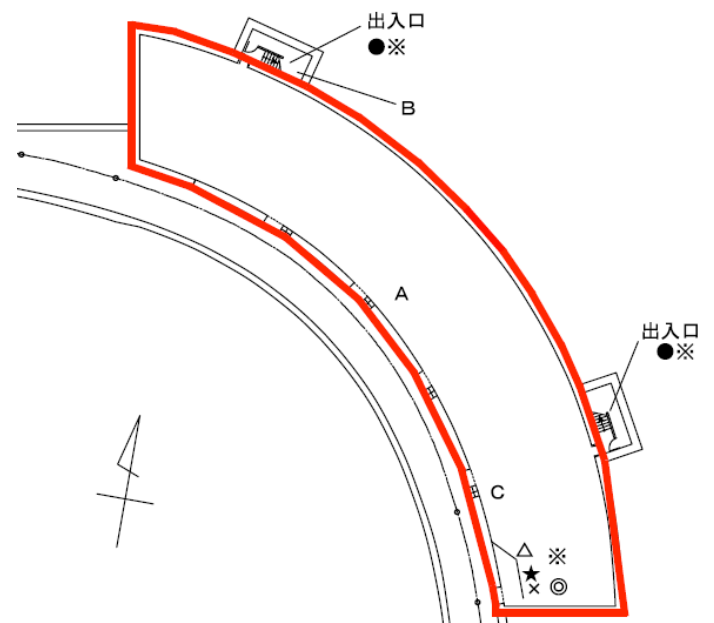


図 7 放射光実験施設・地下 1 階

配布先

機構長

(管理局) 施設部長、施設企画課長、整備管理課長、安全衛生推進室

(素核研) 所長、副所長、事務室

(加速器) 施設長、各主幹、事務室

(物構研) 所長、副所長、事務室

(共通) 施設長、各センター長、事務室、放射線受付

(担当者) 当該発生装置管理責任者、同作業責任者、各区域放射線担当者、  
管理室員