

各位

## AR南実験準備棟600kV光陰極DC電子銃の主任者検査結果について


平成25年7月18日

放射線取扱主任者

佐々木 慎一

PF-AR南実験準備棟地下2階で開発が進められる600kV光陰極DC電子銃の機構長の指定する放射線発生装置としての使用開始について、7月18日に管理区域設定、標識、インターロックおよび標識について主任者検査を行い、同日付で使用を認めましたのでお知らせします。

### AR南実験準備棟地下2階

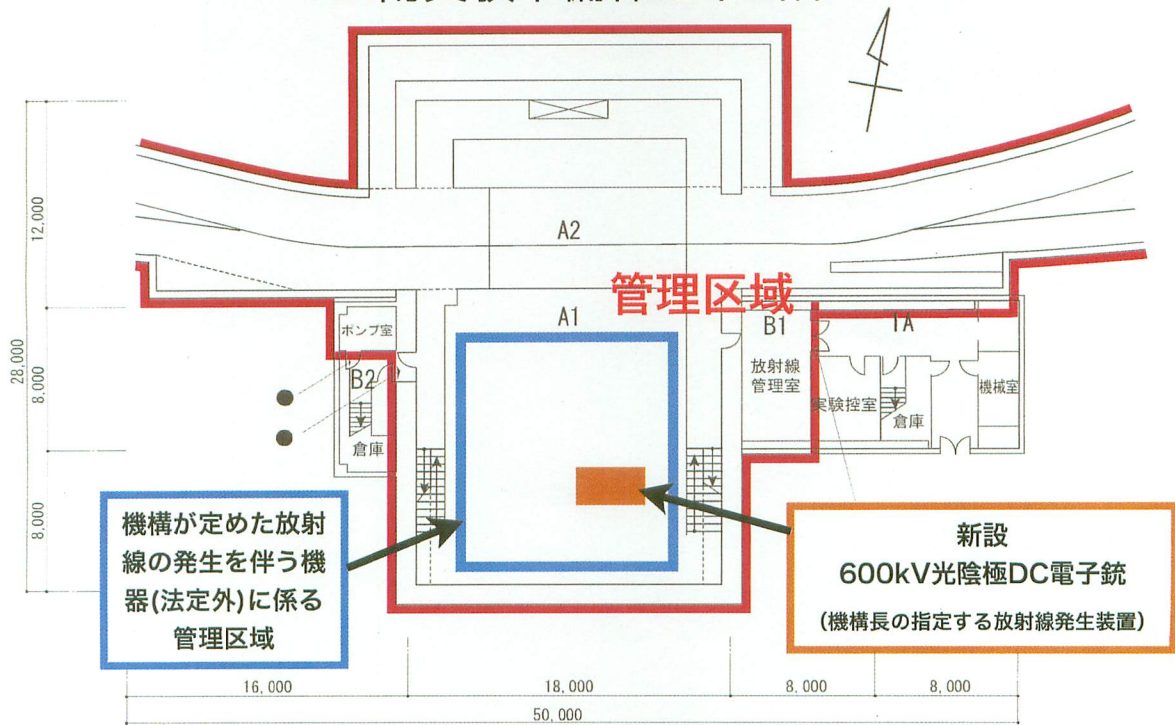

当該主幹等： 小林 幸則  
放射線発生装置責任者： 宮島 司  
放射線担当者： 本田 融  
放射線区域責任者： 岩瀬 広  
加速粒子： 電子  
性能等： 最大印可電圧 600kV、最大ビーム電流 100 $\mu$ A

#### 配布先

機構長

(素核研) 所長、副所長

(物構研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、総主幹、各主幹

(共通) 施設長、各センター長

安全衛生推進室、施設部、各区域放射線担当者、各研究施設事務室